

uw kuit in verhouding tot uw enkel erg dik is
adviseeren wij u 1 maat groter te nemen.

sionsstrümpfe
sche Einsatz-
ist klinisch getestet
rombose entgegen.
fällt „strik“ weise
Wade ab und fördert
zum Herzen und zur
nen sich

prophylaxe

rapie bei Varizen

erstauchten

Beine (stehende

SolvaCare est un
cherches cliniques
du niveau de com-
on des thromboses
pression graduée,
e vers la cuisse,
ers le cœur et les
solution efficace

e veineuse

se du voyageur !)

ment des varices

es de chevilles

urdes (professions
ébout prolongée)

OM

Anmessung der Strümpfe:

Messen Sie Ihren Fußknöchelumfang ca. 2 cm über dem Fußknöchel. Wählen Sie den Strumpf mit dem Knöchelumfang, der zu Ihrem Messwert passt. Falls Sie das SolvaCare-Messband benutzen, können Sie mittels der Skala des Fußknöchelumfangs den entsprechenden Farbcode der Strümpfe ablesen. Falls Ihr Wadenumfang verglichen mit dem Fußknöchelumfang größer ist, empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.


Prise de mesure des bas :

mesurez le tour de la cheville environ 2 cm au-dessus de la malléole. Choisissez les bas de la taille correspondant à votre tour de cheville. Si vous utilisez le mètre ruban SolvaCare, la couleur correspondant à votre tour de cheville indique le code couleur des bas adaptés. Si votre mollet est relativement gros par rapport à votre cheville, nous vous conseillons de prendre 1 taille au-dessus.



SolvaCare B.V. Arnoudstraat 20,
2182 DZ Hillegom, The Netherlands

CE

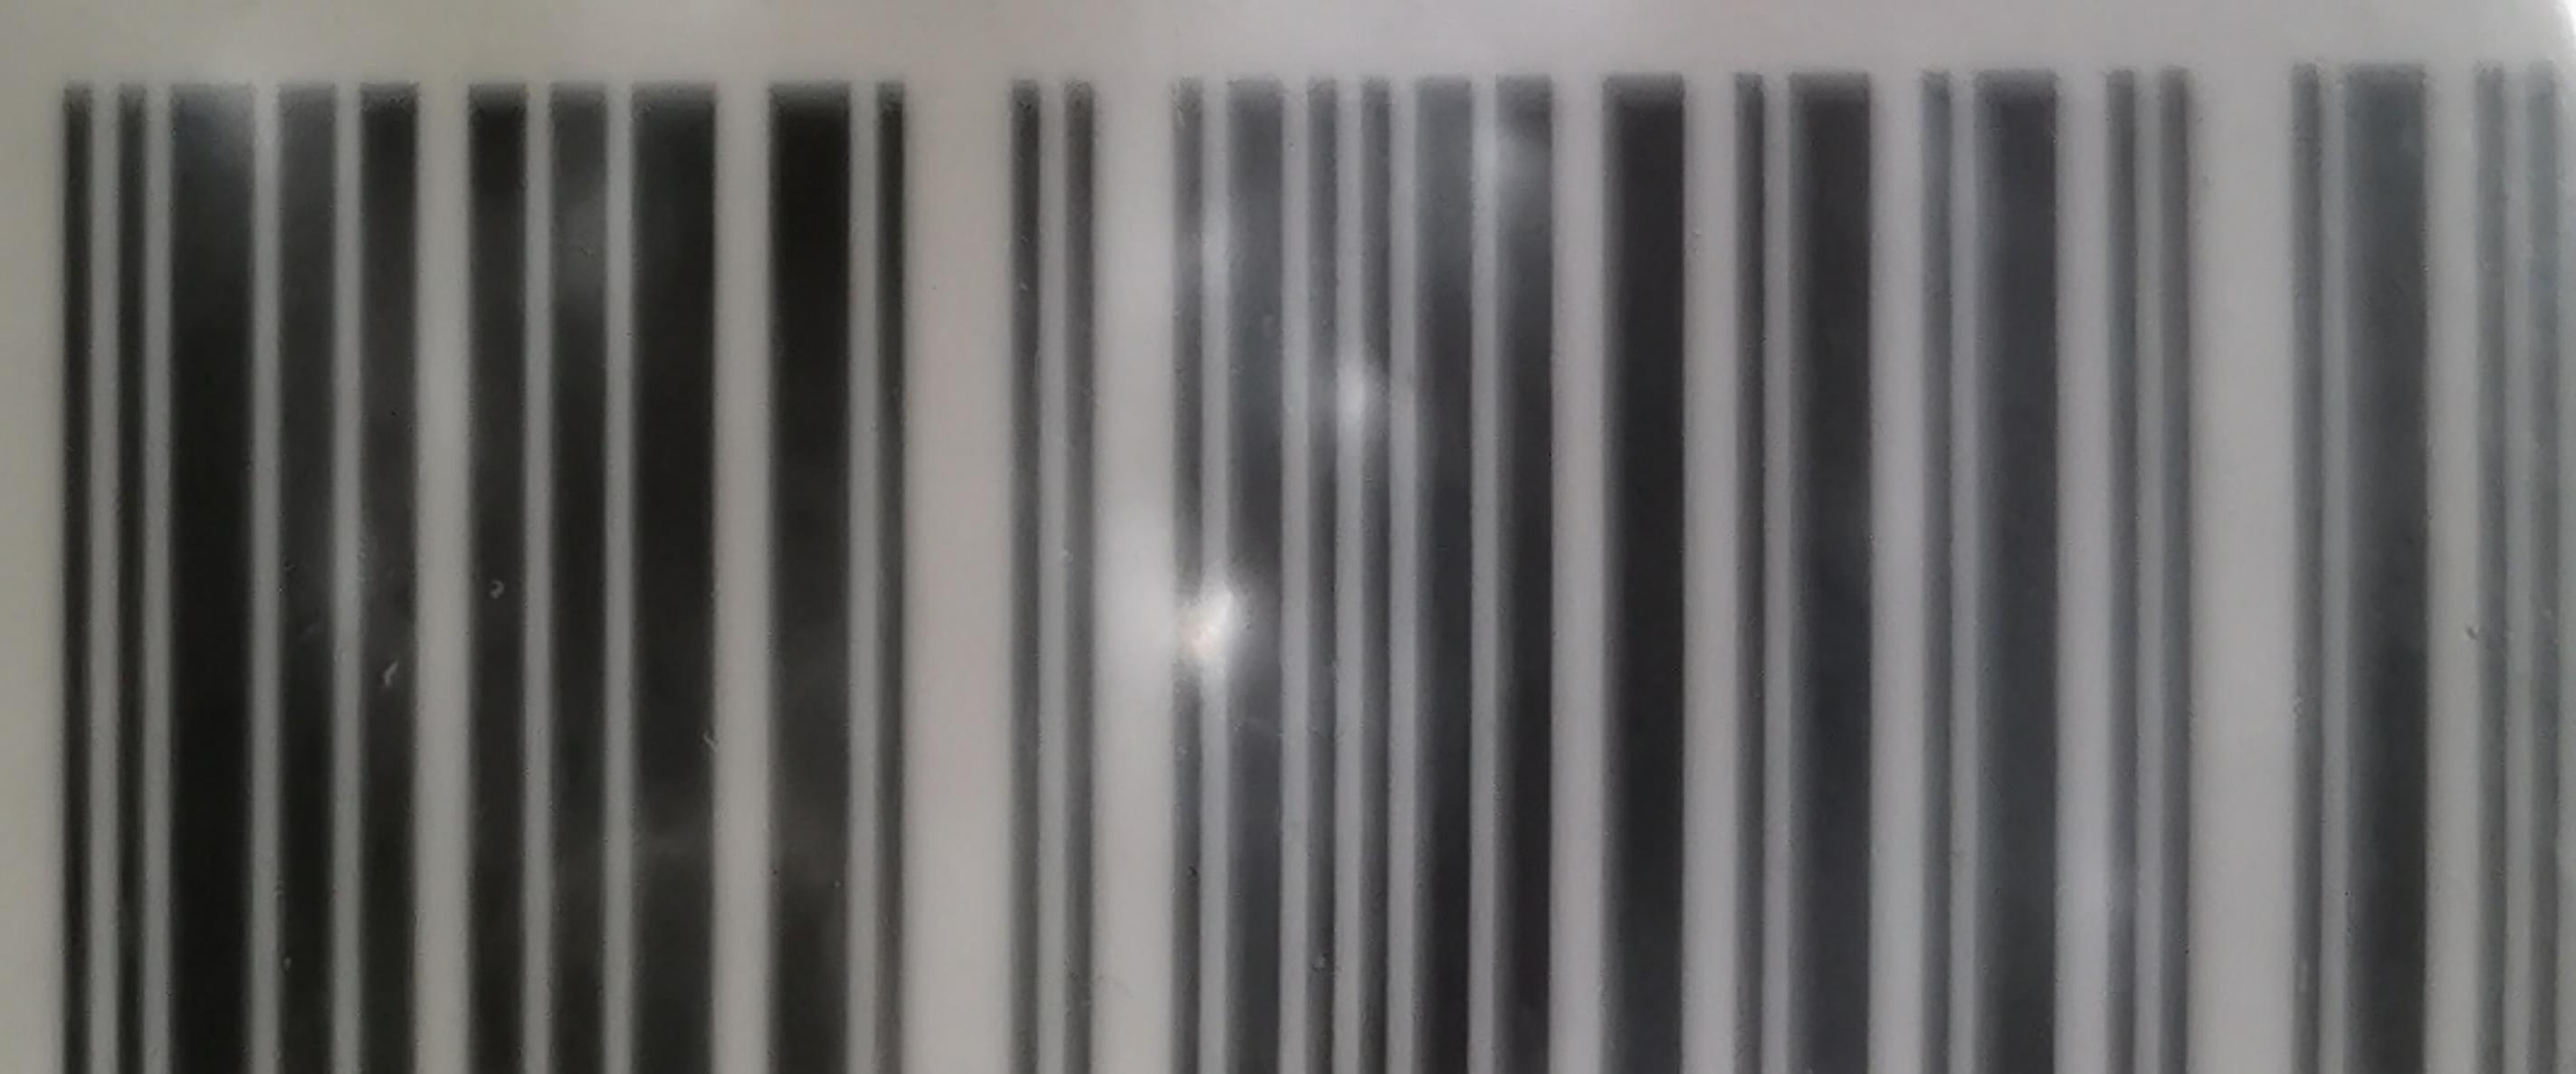

8 718469 200030